



Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Herverdeling CVVH-apparatuur

LCPS, 16 april 2020


Herverdeling van CVVH-apparatuur in Nederland

- De afgelopen dagen heeft LCPS diverse signalen ontvangen van ziekenhuizen die behoefte hebben aan extra CVVH-apparatuur voor de IC. LCPS is op dit moment verantwoordelijk voor de allocatie van nieuwe CVVH-apparatuur over ziekenhuizen. De komende maanden komt er echter waarschijnlijk geen nieuwe CVVH-apparatuur beschikbaar in Nederland.
- Ziekenhuizen die structureel behoefte hebben aan extra CVVH-apparatuur, kunnen mogelijk apparatuur (tijdelijk) uitwisselen met ziekenhuizen die over meer apparaten beschikken. De ROAZ heeft zicht op de aanwezige CVVH-apparatuur in de regio en heeft nauw contact met andere ROAZ-en. Als een ROAZ een ziekenhuis bereid vindt voor (tijdelijke) uitwisseling van de apparatuur, dan zorgen de ROAZ-en voor contact tussen de bestuurders van beide ziekenhuizen. De bestuurder stellen onderling vast onder welke voorwaarden wordt uitgewisseld.
- LCPS ondersteunt de ROAZ-en met een analyse van de aanwezige CVVH-apparatuur per ziekenhuis en de totale aanwezigheid in alle ROAZ-regio's. Deze analyse kunnen ROAZ-en gebruiken om potentiële ziekenhuizen te vinden voor uitwisseling.



Sommige regio's hebben meer CVVH-apparatuur dan andere regio's

Aantal CVVH-apparaten per 100 COVID-IC-patiënten¹ [# (totaal aantal apparaten)]

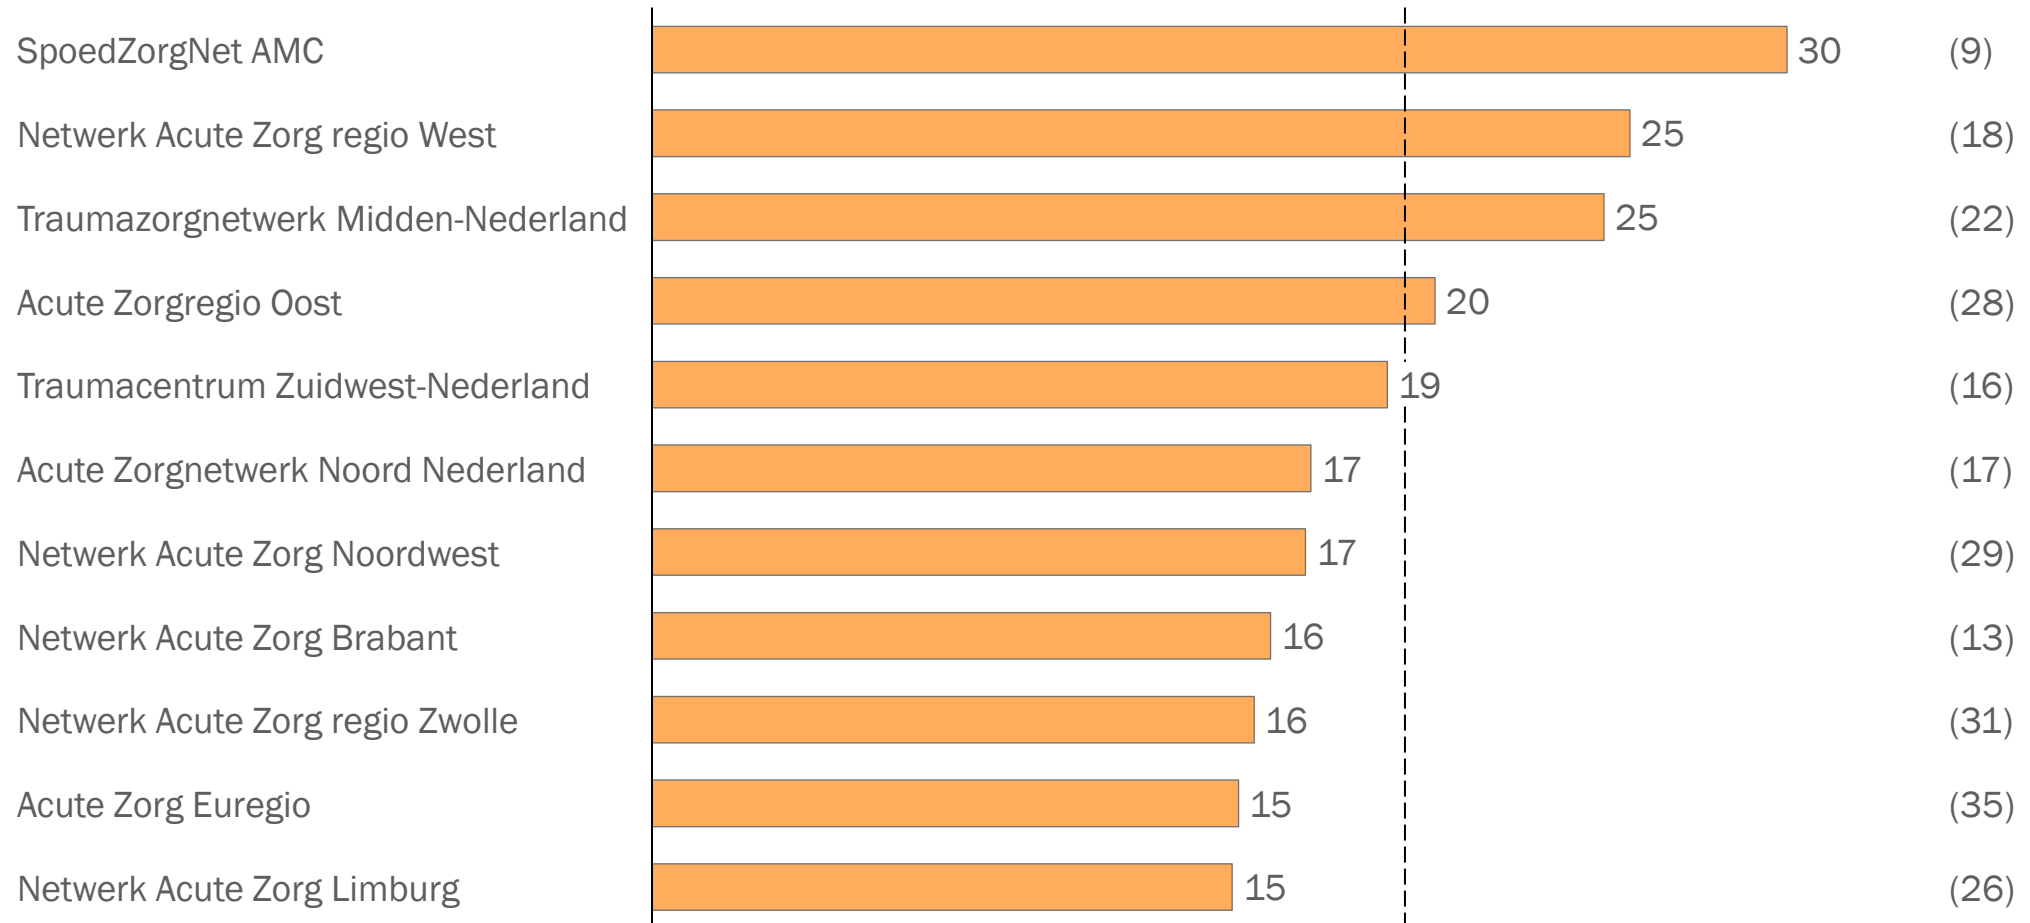

1) Gegeven de 1.242 COVID-IC-patiënten op 10 april
Bron: Stichting NICE voor IC-bedden (10-04-2020), uitvraag NFN voor CVVH-apparatuur (25-03-2020)

Gem. NL: 20